


## Smart Digital Thermometer Eco Temp Intelli IT (MC-280B)

### Instruction Manual



## All for Healthcare

### 1. Introduction

Thank you for purchasing the OMRON Digital Thermometer Eco Temp Intelli IT. This thermometer eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Note that your temperature is affected by smoking, eating or drinking. Contact your doctor if you have any questions regarding specific temperatures.

### Intended Use

The thermometer you purchased offers a safe, accurate and quick temperature reading. You can measure your temperature either in the mouth (orally) or underarm (axillary).

### Intended Operator

This thermometer is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual. It is mainly designed for household use.

### 2. Important Safety Information

Read the Important Safety Information in this instruction manual before using this device. Follow this instruction manual thoroughly for your safety. Keep for future reference.

**Warning** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Keep the thermometer out of the reach of infants, toddlers and children. DO NOT allow children to operate/use the thermometer while unattended. Children may injure themselves or other children when attempting to take temperatures without appropriate supervision.
- To help avoid choking, keep the battery, battery cover and screw away from infants, toddlers and children. If any of these are swallowed, consult with your physician immediately.
- NEVER diagnose or treat yourself based on your temperature readings. ALWAYS consult your physician.
- DO NOT use the thermometer to measure anything other than human body temperature.
- This thermometer is designed for oral and underarm temperature measurements only. DO NOT attempt to take temperature at other sites, such as in the ear or rectum, as it may result in false readings and may lead to injury.
- DO NOT attempt to take temperature measurements when the thermometer is wet. It may cause inaccurate readings.
- DO NOT use the device with other medical electrical (ME) equipment. DO NOT use the device in incorrect operation of the device and/or cause an inaccurate reading.

### Battery Handling and Usage

DO NOT throw the thermometer into fire.

**Caution** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient, or cause damage to the equipment or other property.

- This thermometer does not have water-resistant functionality. DO NOT immerse the thermometer in water.
- DO NOT use the thermometer in places where strong static electricity or electromagnetic fields are present. It may cause an inaccurate measurement result and/or cause the thermometer to operate incorrectly.
- DO NOT allow the thermometer to be shared among individuals without the use of disinfecting the device.
- DO NOT disassemble or attempt to repair the thermometer. It may cause inaccurate reading and/or result in incorrect operation of the thermometer.
- DO NOT bite on the thermometer. It may cause breakage and/or injury.
- The display will show "L" (or the actual temperature if it is stored in warm ambient environment above 32.0 °C).
- DO NOT use this thermometer in places with high or low humidity or high or low temperatures. Refer to section 9.
- DO NOT drop the thermometer or storage case or subject them to strong shock or vibration.
- During measurement, make sure that no mobile device or any other electrical devices that emit electromagnetic fields is within 30 cm of this thermometer. This may result in incorrect operation of the thermometer and/or cause an inaccurate reading.


### Battery Handling and Usage

- DO NOT insert the battery with its polarity incorrectly aligned.
- ONLY use a CR1220 LITHIUM button battery with this thermometer. DO NOT use any other type of battery.
- Remove the battery when the thermometer will not be used for 3 months or more.
- If battery fluid gets in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Consult with your physician immediately.
- DO NOT replace the battery while the power is on.
- DO NOT use the battery after its expiration date.

### 3. Measuring Temperature Correctly

Measurement accuracy cannot be guaranteed when the thermometer is incorrectly used to take a temperature measurement.


**Oral use (for ages 4 and older):**  
Place the mouth sensor tip in your mouth for 5 minutes before measurement.  
Place the thermometer in the mouth under the tongue so that it rests to the left or right of the root of the tongue.  
Use downward tongue pressure to hold the thermometer in place.  
Hold the thermometer to keep it from sliding around in the mouth.



### Underarm use:

- Place the sensor tip in the centre of the underarm.
- Turn the display so that it faces inwards.
- Lock the sensor tip under the arm, using the arm to slightly apply pressure inwards.
- The angle should be 35 - 45° in relation to the arm.

## OMRON



## All for Healthcare

### 1. Introduction

Thank you for purchasing the OMRON Digital Thermometer Eco Temp Intelli IT. This thermometer eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Note that your temperature is affected by smoking, eating or drinking. Contact your doctor if you have any questions regarding specific temperatures.

### Intended Use

The thermometer you purchased offers a safe, accurate and quick temperature reading. You can measure your temperature either in the mouth (orally) or underarm (axillary).

### Intended Operator

This thermometer is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual. It is mainly designed for household use.

### 2. Important Safety Information

Read the Important Safety Information in this instruction manual before using this device. Follow this instruction manual thoroughly for your safety. Keep for future reference.

**Warning** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Keep the thermometer out of the reach of infants, toddlers and children. DO NOT allow children to operate/use the thermometer while unattended. Children may injure themselves or other children when attempting to take temperatures without appropriate supervision.
- To help avoid choking, keep the battery, battery cover and screw away from infants, toddlers and children. If any of these are swallowed, consult with your physician immediately.
- NEVER diagnose or treat yourself based on your temperature readings. ALWAYS consult your physician.
- DO NOT use the thermometer to measure anything other than human body temperature.
- This thermometer is designed for oral and underarm temperature measurements only. DO NOT attempt to take temperature at other sites, such as in the ear or rectum, as it may result in false readings and may lead to injury.
- DO NOT attempt to take temperature measurements when the thermometer is wet. It may cause inaccurate readings.
- DO NOT use the device with other medical electrical (ME) equipment. DO NOT use the device in incorrect operation of the device and/or cause an inaccurate reading.

### Battery Handling and Usage

DO NOT throw the thermometer into fire.

**Caution** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient, or cause damage to the equipment or other property.

- This thermometer does not have water-resistant functionality. DO NOT immerse the thermometer in water.
- DO NOT use the thermometer in places where strong static electricity or electromagnetic fields are present. It may cause an inaccurate measurement result and/or cause the thermometer to operate incorrectly.
- DO NOT allow the thermometer to be shared among individuals without the use of disinfecting the device.
- DO NOT disassemble or attempt to repair the thermometer. It may cause inaccurate reading and/or result in incorrect operation of the thermometer.
- DO NOT bite on the thermometer. It may cause breakage and/or injury.
- The display will show "L" (or the actual temperature if it is stored in warm ambient environment above 32.0 °C).
- DO NOT use this thermometer in places with high or low humidity or high or low temperatures. Refer to section 9.
- DO NOT drop the thermometer or storage case or subject them to strong shock or vibration.
- During measurement, make sure that no mobile device or any other electrical devices that emit electromagnetic fields is within 30 cm of this thermometer. This may result in incorrect operation of the thermometer and/or cause an inaccurate reading.

### Battery Handling and Usage

- DO NOT insert the battery with its polarity incorrectly aligned.
- ONLY use a CR1220 LITHIUM button battery with this thermometer. DO NOT use any other type of battery.
- Remove the battery when the thermometer will not be used for 3 months or more.
- If battery fluid gets in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Consult with your physician immediately.
- DO NOT replace the battery while the power is on.
- DO NOT use the battery after its expiration date.

### 3. Measuring Temperature Correctly

Measurement accuracy cannot be guaranteed when the thermometer is incorrectly used to take a temperature measurement.

**Oral use (for ages 4 and older):**  
Place the mouth sensor tip in your mouth for 5 minutes before measurement.  
Place the thermometer in the mouth under the tongue so that it rests to the left or right of the root of the tongue.  
Use downward tongue pressure to hold the thermometer in place.  
Hold the thermometer to keep it from sliding around in the mouth.




### Underarm use:

- Place the sensor tip in the centre of the underarm.
- Turn the display so that it faces inwards.
- Lock the sensor tip under the arm, using the arm to slightly apply pressure inwards.
- The angle should be 35 - 45° in relation to the arm.

Go to next column for the next step

## Place the thermometer on your smartphone's microphone as the illustration to the right.



## All for Healthcare

### 1. Introduction

Thank you for purchasing the OMRON Digital Thermometer Eco Temp Intelli IT. This thermometer eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Note that your temperature is affected by smoking, eating or drinking. Contact your doctor if you have any questions regarding specific temperatures.

### Intended Use

The thermometer you purchased offers a safe, accurate and quick temperature reading. You can measure your temperature either in the mouth (orally) or underarm (axillary).

### Intended Operator

This thermometer is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual. It is mainly designed for household use.

### 2. Important Safety Information

Read the Important Safety Information in this instruction manual before using this device. Follow this instruction manual thoroughly for your safety. Keep for future reference.

**Warning** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Keep the thermometer out of the reach of infants, toddlers and children. DO NOT allow children to operate/use the thermometer while unattended. Children may injure themselves or other children when attempting to take temperatures without appropriate supervision.
- To help avoid choking, keep the battery, battery cover and screw away from infants, toddlers and children. If any of these are swallowed, consult with your physician immediately.
- NEVER diagnose or treat yourself based on your temperature readings. ALWAYS consult your physician.
- DO NOT use the thermometer to measure anything other than human body temperature.
- This thermometer is designed for oral and underarm temperature measurements only. DO NOT attempt to take temperature at other sites, such as in the ear or rectum, as it may result in false readings and may lead to injury.
- DO NOT attempt to take temperature measurements when the thermometer is wet. It may cause inaccurate readings.
- DO NOT use the device with other medical electrical (ME) equipment. DO NOT use the device in incorrect operation of the device and/or cause an inaccurate reading.

### Battery Handling and Usage

DO NOT throw the thermometer into fire.

**Caution** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient, or cause damage to the equipment or other property.

- This thermometer does not have water-resistant functionality. DO NOT immerse the thermometer in water.
- DO NOT use the thermometer in places where strong static electricity or electromagnetic fields are present. It may cause an inaccurate measurement result and/or cause the thermometer to operate incorrectly.
- DO NOT allow the thermometer to be shared among individuals without the use of disinfecting the device.
- DO NOT disassemble or attempt to repair the thermometer. It may cause inaccurate reading and/or result in incorrect operation of the thermometer.
- DO NOT bite on the thermometer. It may cause breakage and/or injury.
- The display will show "L" (or the actual temperature if it is stored in warm ambient environment above 32.0 °C).
- DO NOT use this thermometer in places with high or low humidity or high or low temperatures. Refer to section 9.
- DO NOT drop the thermometer or storage case or subject them to strong shock or vibration.
- During measurement, make sure that no mobile device or any other electrical devices that emit electromagnetic fields is within 30 cm of this thermometer. This may result in incorrect operation of the thermometer and/or cause an inaccurate reading.


### Battery Handling and Usage

- DO NOT insert the battery with its polarity incorrectly aligned.
- ONLY use a CR1220 LITHIUM button battery with this thermometer. DO NOT use any other type of battery.
- Remove the battery when the thermometer will not be used for 3 months or more.
- If battery fluid gets in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Consult with your physician immediately.
- DO NOT replace the battery while the power is on.
- DO NOT use the battery after its expiration date.

### 3. Measuring Temperature Correctly

Measurement accuracy cannot be guaranteed when the thermometer is incorrectly used to take a temperature measurement.

**Oral use (for ages 4 and older):**  
Place the mouth sensor tip in your mouth for 5 minutes before measurement.  
Place the thermometer in the mouth under the tongue so that it rests to the left or right of the root of the tongue.  
Use downward tongue pressure to hold the thermometer in place.  
Hold the thermometer to keep it from sliding around in the mouth.

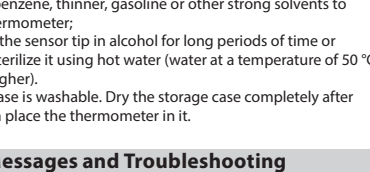

### Underarm use:

- Place the sensor tip in the centre of the underarm.
- Turn the display so that it faces inwards.
- Lock the sensor tip under the arm, using the arm to slightly apply pressure inwards.
- The angle should be 35 - 45° in relation to the arm.

Go to next column for the next step

Display/Problem	Possible Cause	Solution
"AH" appears.	The thermometer is/was stored in a location where the temperature is/was 40 °C (104 °F) or more.	Take a temperature measurement after leaving the thermometer in a location where the temperature is between 10 and 40 °C (50 and 104 °F) for at least 1 minute.
"AL" appears.	The thermometer is/was stored in a location where the temperature is/was lower than 10 °C (50 °F).	This is not a malfunction. Keep taking a temperature measurement.
When the thermometer is turned on "L" appears.	The temperature of the sensor tip is lower than 32 °C (89.6 °F).	This is not a malfunction. Keep taking a temperature measurement.
When the thermometer is turned on "H" appears.	The temperature of the sensor tip is higher than 42 °C (107.6 °F).	Cool the sensor tip with a damp towel and then take a temperature measurement.
When the thermometer is turned on a random reading between 32.0 to 42.0 °C (89.6 to 107.6 °F) appears any time.	The sensor tip is warm and the display shows the actual ambient temperature, if the ambient temperature is higher than 32 °C (89.6 °F).	Replacing the battery with new one is recommended. Refer to section 5.
Nothing appears or "C" and "A1" appear on the display when the power button is pressed.	Battery polarity is not properly aligned.	Check the battery installation for proper placement. Refer to section 5.
Battery is depleted.	Immediately replace new battery. Refer to section 5.	Nothing appears or "C" and "A1" appear on the display when the power button is pressed.
Difference in temperature between 2 consecutive measurements or between different thermometers.	Complete the measurements for the full measurement time. Different measurement times can lead to minor differences between measurement results.	Check the battery installation for proper placement. Refer to section 5.
The temperature readings are inconsistent.	The thermometer is being placed at a different measurement site for each measurement.	Immediately replace new battery. Refer to section 5.
Transferring the thermometer is not successfully completed.	The thermometer is too far from your smartphone's microphone. The environment during the transfer of the thermometer is too noisy.	Apply the thermometer correctly. Refer to section 3. Bring the thermometer closer to your smartphone's microphone. Transfer your temperature in a quieter place.

In case of any of the below problems occur, the measurement may be done incorrectly taken, refer to section 3.

- The temperature reading is higher than usual or "H" appears on the display instead of the temperature measurement result.
- The temperature reading is lower than usual or "L" appears on the display instead of the temperature measurement result.

**9. Specifications**

Product category	Clinical Electronic Thermometers
Product description	Smart Digital Thermometer
Model (code)	Eco Temp Intelli IT (MC-280B)
Sensing unit	Thermistor
Measurement accuracy	±0.1 °C (±2.0 to 42.0 °C) / ±0.2 °F (89.6 to 107.6 °F) (When measured at a standard body temperature of 32 °C (73.4 °F) in a test tank held at constant temperature)
Temperature display	3 digits (°C), or 4 digits (°F) display in 0.1 degree increments
Measurement position	Oral, underarm
Measurement time	Underarm: approximately 10 minutes; Oral: approximately 5 minutes
Power supply	3 V DC, CR1220 lithium button battery
Durable period (service life)	5 years
Battery life	Approx. 1.5 years or more (1 time per day)
Measurement method	Actual temperature measurement (non-predictive)
Operating mode	Continuous operation
Applied part	Type BF (sensor tip and probe)
Protection against electric shock	Internally powered ME equipment
Measurement range	32.0 to 42.0 °C (89.6 to 107.6 °F)
Memory	1 Memory
Operating conditions	+10 to +40 °C (+50 to +104 °F), 30 to 85% RH (non-condensing), 700 - 1060 hPa
Storage/Transport conditions (between uses)	-20 to +60 °C (-4 to +140 °F), 10 to 90% RH (non-condensing)
Weight	Approx. 14 g (with battery installed)
Dimensions	Approx. 20.1 mm (W) x 136.8 mm (L) x 12.8 mm (D)
Package contents	Main unit, CR1220 lithium button battery, storage case, instruction manual

**Handhabung und Verwendung der Batterie**  
Setzen Sie die Batterie NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen Seiten) ein. Für dieses Thermometer darf NUR eine CR1220 Lithium-Batterie verwendet werden. Verwenden Sie KEINE anderen Batterietypen.  
Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.  
Nehmen Sie Batterien aus den Augen gelagert, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser aus. Waschen Sie die Batterie NICHT aus, während das Thermometer eingeschaltet ist.  
Verwenden Sie die Batterie NICHT nach dem Ablaufdatum.

**3. Korrektes Messen der Temperatur**  
Die Messgenauigkeit kann nicht garantiert werden, wenn die Temperaturmessung in einem unruhigen oder nicht korrekt durchgeführte wird.  
**Orale Anwendung (ab einem Alter von vier Jahren)**  
• Vor der Messung sollte der Mund 5 Minuten geschlossen bleiben.  
• Das Fieberthermometer im Mund unter der Zunge platzieren, sodass es links oder rechts der Zungenwurzel ruht.  
• Halten Sie das Fieberthermometer durch Druck mit der Zunge nach unten an seinem Platz.  
• Halten Sie das Thermometer fest und schieben Sie es nicht mit der Zunge hin und her.


**Handhabung und Verwendung der Batterie**  
Setzen Sie die Batterie NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen Seiten) ein. Für dieses Thermometer darf NUR eine CR1220 Lithium-Batterie verwendet werden. Verwenden Sie KEINE anderen Batterietypen.  
Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.  
Nehmen Sie Batterien aus den Augen gelagert, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser aus. Waschen Sie die Batterie NICHT aus, während das Thermometer eingeschaltet ist.  
Verwenden Sie die Batterie NICHT nach dem Ablaufdatum.

**3. Korrektes Messen der Temperatur**  
Die Messgenauigkeit kann nicht garantiert werden, wenn die Temperaturmessung in einem unruhigen oder nicht korrekt durchgeführte wird.  
**Orale Anwendung (ab einem Alter von vier Jahren)**  
• Vor der Messung sollte der Mund 5 Minuten geschlossen bleiben.  
• Das Fieberthermometer im Mund unter der Zunge platzieren, sodass es links oder rechts der Zungenwurzel ruht.  
• Halten Sie das Fieberthermometer durch Druck mit der Zunge nach unten an seinem Platz.  
• Halten Sie das Thermometer fest und schieben Sie es nicht mit der Zunge hin und her.

**Messung in der Achselhöhle:**  
• Platzieren Sie die Messspitze in der Mitte der Achselhöhle.  
• Drehen Sie die Anzeige so, dass diese nach innen zeigt.  
• Fixieren Sie die Messspitze durch leichten Druck nach innen unter dem Arm.  
• Der Winkel zum Arm sollte 35° bis 45° betragen.

## Intelligentes digitales Thermometer Eco Temp Intelli IT (MC-280B)

### Gebrauchsanweisung



## All for Healthcare

### 1. Einführung

Thank you for purchasing the OMRON Digital Thermometer Eco Temp Intelli IT. This thermometer eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Note that your temperature is affected by smoking, eating or drinking. Contact your doctor if you have any questions regarding specific temperatures.

### Intended Use

The thermometer you purchased offers a safe, accurate and quick temperature reading. You can measure your temperature either in the mouth (orally) or underarm (axillary).

### Intended Operator

This thermometer is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual. It is mainly designed for household use.

### 2. Wichtige Sicherheitsinformationen

Read the Important Safety Information in this instruction manual before using this device. Follow this instruction manual thoroughly for your safety. Keep for future reference.

**Warning** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Bewahren Sie das Thermometer für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen das Thermometer NICHT unbeaufsichtigt verwenden. Beim Versuch, die Temperatur ohne angemessene Beaufsichtigung zu messen, können Kinder sich selbst oder andere Kinder verletzen.
- Batterien, Batterieabdeckung und Schraube sollten außer Reichweite von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern aufbewahrt werden, da Erstickengefahr besteht. Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn eines dieser Teile verschluckt wurde.
- Die Temperaturmesswerte sollten NIE zur Eigen Diagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden. Wenden Sie sich IMMER an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Thermometer AUSSCHLIESSLICH zum Messen der menschlichen Körpertemperatur.
- Dieses Thermometer ist nur zur Temperaturmessung im Mund oder unter dem Arm vorgesehen. Messen Sie die Temperatur NICHT an anderen Stellen, beispielsweise im Ohr oder im After (rektal), da dies zu falschen Messungen und Verletzungen führen kann.
- Führen Sie keine Temperaturmessung durch, wenn das Thermometer nass ist. Dies könnte zu falschen Messwerten führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT gleichzeitig mit anderen medizinischen elektrischen Geräten. Dies könnte zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und/oder zu falschen Messwerten führen.

### Verwendung und Handhabung der Batterie

Setzen Sie die Batterie NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen Seiten) ein. Für dieses Thermometer darf NUR eine CR1220 Lithium-Batterie verwendet werden. Verwenden Sie KEINE anderen Batterietypen.  
Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.  
Nehmen Sie Batterien aus den Augen gelagert, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser aus. Waschen Sie die Batterie NICHT aus, während das Thermometer eingeschaltet ist.  
Verwenden Sie die Batterie NICHT nach dem Ablaufdatum.


**3. Korrektes Messen der Temperatur**  
Die Messgenauigkeit kann nicht garantiert werden, wenn die Temperaturmessung in einem unruhigen oder nicht korrekt durchgeführte wird.  
**Orale Anwendung (ab einem Alter von vier Jahren)**  
• Vor der Messung sollte der Mund 5 Minuten geschlossen bleiben.  
• Das Fieberthermometer im Mund unter der Zunge platzieren, sodass es links oder rechts der Zungenwurzel ruht.  
• Halten Sie das Fieberthermometer durch Druck mit der Zunge nach unten an seinem Platz.  
• Halten Sie das Thermometer fest und schieben Sie es nicht mit der Zunge hin und her.

**Handhabung und Verwendung der Batterie**  
Setzen Sie die Batterie NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen Seiten) ein. Für dieses Thermometer darf NUR eine CR1220 Lithium-Batterie verwendet werden. Verwenden Sie KEINE anderen Batterietypen.  
Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.  
Nehmen Sie Batterien aus den Augen gelagert, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser aus. Waschen Sie die Batterie NICHT aus, während das Thermometer eingeschaltet ist.  
Verwenden Sie die Batterie NICHT nach dem Ablaufdatum.

**3. Korrektes Messen der Temperatur**  
Die Messgenauigkeit kann nicht garantiert werden, wenn die Temperaturmessung in einem unruhigen oder nicht korrekt durchgeführte wird.  
**Orale Anwendung (ab einem Alter von vier Jahren)**  
• Vor der Messung sollte der Mund 5 Minuten geschlossen bleiben.  
• Das Fieberthermometer im Mund unter der Zunge platzieren, sodass es links oder rechts der Zungenwurzel ruht.  
• Halten Sie das Fieberthermometer durch Druck mit der Zunge nach unten an seinem Platz.  
• Halten Sie das Thermometer fest und schieben Sie es nicht mit der Zunge hin und her.

**Messung in der Achselhöhle:**  
• Platzieren Sie die Messspitze in der Mitte der Achselhöhle.  
• Drehen Sie die Anzeige so, dass diese nach innen zeigt.  
• Fixieren Sie die Messspitze durch leichten Druck nach innen unter dem Arm.  
• Der Winkel zum Arm sollte 35° bis 45° betragen.

## OMRON



## All for Healthcare

### 1. Einführung

Thank you for purchasing the OMRON Digital Thermometer Eco Temp Intelli IT. This thermometer eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Note that your temperature is affected by smoking, eating or drinking. Contact your doctor if you have any questions regarding specific temperatures.

### Intended Use

The thermometer you purchased offers a safe, accurate and quick temperature reading. You can measure your temperature either in the mouth (orally) or underarm (axillary).

### Intended Operator

This thermometer is intended to be operated by adults who can understand this instruction manual. It is mainly designed for household use.

### 2. Wichtige Sicherheitsinformationen

Read the Important Safety Information in this instruction manual before using this device. Follow this instruction manual thoroughly for your safety. Keep for future reference.

**Warning** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Bewahren Sie das Thermometer für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen das Thermometer NICHT unbeaufsichtigt verwenden. Beim Versuch, die Temperatur ohne angemessene Beaufsichtigung zu messen, können Kinder sich selbst oder andere Kinder verletzen.
- Batterien, Batterieabdeckung und Schraube sollten außer Reichweite von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern aufbewahrt werden, da Erstickengefahr besteht. Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn eines dieser Teile verschluckt wurde.
- Die Temperaturmesswerte sollten NIE zur Eigen Diagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden. Wenden Sie sich IMMER an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Thermometer AUSSCHLIESSLICH zum Messen der menschlichen Körpertemperatur.
- Dieses Thermometer ist nur zur Temperaturmessung im Mund oder unter dem Arm vorgesehen. Messen Sie die Temperatur NICHT an anderen Stellen, beispielsweise im Ohr oder im After (rektal), da dies zu falschen Messungen und Verletzungen führen kann.
- Führen Sie keine Temperaturmessung durch, wenn das Thermometer nass ist. Dies könnte zu falschen Messwerten führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT gleichzeitig mit anderen medizinischen elektrischen Geräten. Dies könnte zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und/oder zu falschen Messwerten führen.

### Verwendung und Handhabung der Batterie

Setzen Sie die Batterie NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen Seiten) ein. Für dieses Thermometer darf NUR eine CR1220 Lithium-Batterie verwendet werden. Verwenden Sie KEINE anderen Batterietypen.  
Entfernen Sie die Batterie, wenn das Thermometer 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.  
Nehmen Sie Batterien aus den Augen gelagert, spülen Sie diese



6 Placer le thermomètre sur le microphone de votre smartphone comme sur l'illustration à droite. La transmission du résultat de la mesure démarre automatiquement et se poursuit pendant 2 minutes, jusqu'à ce que le thermomètre s'éteigne.

**Remarque**

- Pour de plus amples informations sur le transfert des mesures de température sur votre smartphone, se reporter à l'écran de transfert de l'application.
- Avant d'éteindre le thermomètre, vérifier que votre température a bien été transférée dans l'application.
- Si le son du thermomètre vous dérange, éteindre le thermomètre immédiatement après le transfert des données.

7 Appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre le thermomètre. Nettoyer et désinfecter le thermomètre avant de le remettre dans son étui de rangement. Se reporter à la sous-section 7.2.


**Remarque**

- Le résultat de la mesure de votre température sera automatiquement enregistré dans la mémoire du thermomètre. Le thermomètre ne peut enregistrer que la dernière température mesurée.
- Le thermomètre s'éteint automatiquement :
  - 2 minutes après le début du transfert de la mesure.
  - 30 minutes après le début d'une mesure dont le résultat n'a pas été transféré.


### 5. Remplacement de la pile

Pile : pile bouton au lithium CR1220 (disponible dans le commerce)  
Utiliser la pile dans le délai recommandé par le fabricant.  
Remplacer la pile si les indications « **C** » et « **A1** » s'affichent à l'allumage du thermomètre.

1 Retirer le couvercle de la pile à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.




2 Retirer la pile à l'aide d'un objet fin, un stylo par exemple.




**Remarque**

- Lors du retrait de la pile, faire attention à ne pas se blesser, car la pile pourrait sauter.

3 Insérer la pile neuve en orientant le pôle «+» vers le haut, comme illustré sur l'image suivante.



4 Refermer le couvercle de la pile et le fixer à l'aide de la vis.



**Remarque**

- Il se peut que la pile fournie ait une durée de vie plus courte que des piles neuves.

### 6. Commutation entre °C et °F

1 Lorsque le thermomètre est éteint, appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 15 secondes jusqu'à ce que « F » s'affiche.

Après la commutation, le thermomètre s'éteint automatiquement. Pour passer à °C, répéter la procédure décrite ci-dessus.



### 7. Maintenance

7.1 Stockage  
Ranger le thermomètre dans son étui de rangement. Ne pas conserver le thermomètre :  
- Dans des endroits où il pourrait être exposé à l'eau, car il n'est pas étanche ;  
- Dans des endroits soumis à des températures extrêmes, à l'humidité, à la proximité de appareils de chauffage, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vapeurs corrosives, d'eau de Javel par exemple ;  
- Dans des endroits exposés à des vibrations ou à des chocs.

7.2 Nettoyage et désinfection  
Lors de la désinfection, utiliser un coton-tige humidifié avec un désinfectant à base d'alcool et frotter le thermomètre 2 ou 3 fois.  
- En cas de nettoyage du thermomètre à l'aide d'alcool, veiller à ce que l'alcool n'entre pas en contact avec la section indicatrice.  
- Frotter le thermomètre avec un chiffon doux et propre.  
- Pour les taches rebelles, utiliser un chiffon doux humidifié à l'eau tiède, puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec.  
- Respecter les consignes suivantes afin de ne pas endommager le thermomètre :  
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant, d'essence ou autres solvants agressifs pour nettoyer le thermomètre ;  
- Ne pas tremper l'embout du capteur dans l'alcool pendant un temps prolongé, ni essayer de le stériliser à l'eau chaude (au-dessus de 50 °C (122 °F) ou plus).  
- L'étui de rangement est lavable. Sécher complètement l'étui de rangement après le lavage, puis y ranger le thermomètre.

### 8. Messages d'erreur et dépannage

Si l'un des problèmes ci-dessous se produit pendant la mesure, vérifier qu'aucun autre appareil électronique ne se trouve à moins de 30 cm. Si le problème persiste, se reporter au tableau de cette section.

Affichage/Problème	Cause possible	Solution
Un chiffre de 0 à 4 s'affiche, accompagné de « E ».	Il peut s'agir d'un dysfonctionnement du thermomètre.	S'adresser à votre représentant OMRON.
« AH » s'affiche.	Le thermomètre est/à été conservé dans un endroit où la température est/était égale ou supérieure à 40 °C (104 °F).	Procéder à une mesure de la température après avoir laissé le thermomètre pendant au moins 1 minute dans un endroit où la température est comprise entre 10 et 40 °C (50 et 104 °F).
« AL » s'affiche.	Le thermomètre est/à été conservé dans un endroit où la température est/était inférieure à 10 °C (50 °F).	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Poursuivre la mesure de la température.
Lors de l'allumage du thermomètre, « L » s'affiche.	La température de l'embout du capteur est inférieure à 32 °C (89,6 °F).	Refroidir l'embout du capteur à l'aide d'une serviette humide, puis procéder à la mesure de la température.
Lors de l'allumage du thermomètre, « H » s'affiche.	La température de l'embout du capteur est supérieure à 42 °C (107,6 °F).	Refroidir l'embout du capteur et l'affichage indique la température ambiante réelle, si elle dépasse 32 °C (89,6 °F).
Lors de l'allumage du thermomètre, un résultat aléatoire entre 32,0 et 42,0 °C (89,6 et 107,6 °F) s'affiche.	L'embout du capteur est chaud et l'affichage indique la température ambiante réelle, si elle dépasse 32 °C (89,6 °F).	Appliquer le thermomètre correctement. Se reporter à la section 5.
« C » clignote à l'importe quel moment.	La pile est déchargée.	Il est recommandé de remplacer la pile par une neuve. Se reporter à la section 5.
Lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé, rien ne s'affiche ou « C » et « A1 » s'affichent.	La polarité de la pile n'est pas alignée correctement. La pile est épuisée.	Vérifier que les piles sont correctement installées. Se reporter à la section 5. Remplacer immédiatement la pile par une neuve. Se reporter à la section 5.
Différence de température entre 2 mesures consécutives ou entre thermomètres différents.	Effectuer les mesures en respectant la durée de mesure complète. Des durées de mesure différentes peuvent donner lieu à des résultats légèrement différents.	Appliquer le thermomètre correctement. Se reporter à la section 5.
Les résultats des mesures sont différents.	Le thermomètre est placé sur un site de mesure différent à chaque mesure.	Appliquer le thermomètre correctement. Se reporter à la section 3.
La transfert de la température à l'échoué.	Le thermomètre se trouve trop loin du microphone de votre smartphone. Il y a trop de bruit ambiant pendant le transfert de la température.	• Rapprocher le thermomètre du microphone du smartphone. • Procéder au transfert de la température dans un endroit plus calme.

Si l'un des problèmes décrits ci-dessous se produit, il se peut que la mesure n'ait pas été effectuée correctement. Se reporter à la section 3.

- Le résultat de la mesure est plus élevé que d'habitude, ou « H » s'affiche au lieu du résultat de la mesure.  
- Le résultat de la mesure est moins élevé que d'habitude, ou « L » s'affiche au lieu du résultat de la mesure.

**9. Spécifications**

Catégorie de produit	Thermomètres médicaux électroniques
Description du produit	Thermomètre digital intelligent
Modèle (réf.)	Eco Temp Intelli IT (MC-280B)
Unité de détection	Thermistance
Précision de la mesure	±0,1 °C (32,0 à 42,0 °C) ±0,2 °F (89,6 à 107,6 °F) (lorsque la mesure est effectuée à la température ambiante standard de 23 °C (73,4 °F) dans un bac de test maintenu à température constante)
Endroit de mesure	Bouche, aisselle
Durée de la mesure	Voie aisselle : environ 10 minutes ; Voie orale : environ 5 minutes
Alimentation électrique	Pile bouton au lithium 3 V CC CR1220
Durée de vie de l'appareil	5 ans
Durée de vie de la pile	Environ 1,5 an ou plus (utilisation 1 fois par jour)
Méthode de mesure	Mesure de la température réelle (non predictive)
Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Pièce applicable	Type BF (embout du capteur et sonde)
Protection contre les chocs électriques	Équipement ME à alimentation interne
Plage de mesure	32,0 à 42,0 °C (89,6 à 107,6 °F)
Mémoire	1 mémoire
Conditions d'utilisation	+10 à +40 °C (+50 à +104 °F), 30 à 85 % HR (sans condensation), 700 à 1060 hPa
Conditions de stockage et de transport (entre utilisations)	-20 à +60 °C (-4 à +140 °F), 10 à 90 % HR (sans condensation)
Poids	Environ 14 g (avec la pile)
Dimensions	Environ 20,1 mm (l) × 136,8 mm (L) × 12,8 mm (P)
Contenu de l'emballage	Unité principale, pile bouton au lithium CR1220, étui de rangement, mode d'emploi


« Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. »  
L'embout du capteur du thermomètre contient du nickel.  
Ce thermomètre ne contient pas de composant réparable par l'utilisateur. OMRON recommande de faire vérifier la précision tous les deux ans par un représentant OMRON.  
La classification du mode de fonctionnement est conforme à la norme CEI 60601-1.  
Cet appareil est conforme aux dispositions de la norme européenne EN12470-3:2000-A1:2009, Thermomètres médicaux - Partie 3 : performances des thermomètres électriques compacts (à comparaison et à extrapolation) avec dispositif à maximum.  
Signalier fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel vous êtes établi tout incident grave qui s'est produit impliquant cet appareil.

« Ce produit OMRON est fabriqué selon le système de qualité strict de OMRON Healthcare Co. Ltd., Japon. »

Date de publication : 2020-09-25

## IT Termometro digitale smart Eco Temp Intelli IT (MC-280B)

### Manuale di istruzioni



### All for Healthcare

**1. Introduzione**  
Grazie per aver acquistato il termometro digitale OMRON Eco Temp Intelli IT. Questo termometro consente di eliminare i fastidi associati all'eventuale rottura del vetro e i rischi derivanti dal mercurio. Si tenga presente che la temperatura corporea è influenzata dal fumo e dall'assunzione di cibi e bevande. Per qualsiasi domanda legata a una specifica temperatura corporea, rivolgersi al proprio medico curante.

**Destinazione d'uso**  
Il termometro consente di misurare la temperatura con sicurezza, precisione e rapidità. Il termometro può essere usato per la misurazione della temperatura tramite la bocca (orale) o sotto il braccio (ascellare).

**Utilizzatori previsti**  
Questo termometro è destinato all'uso da parte di persone adulte in grado di comprendere il presente manuale di istruzioni. Questo dispositivo è progettato principalmente per l'utilizzo domestico.

### 2. Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo leggere le informazioni importanti sulla sicurezza nel presente manuale di istruzioni. Per la propria sicurezza, seguire attentamente le indicazioni fornite nel presente manuale di istruzioni. Conservare il manuale per farvi riferire in futuro.

### Avvertenza

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni gravi o la morte.

Conservare il termometro al di fuori della portata dei neonati e dei bambini. NON lasciare azionare/utilizzare il termometro dai bambini se non in presenza di un adulto. I bambini potrebbero ferirsi se stessi o altri bambini nel tentativo di misurare la temperatura da soli, senza un'adeguata supervisione.  
Per evitare il rischio di sovraccarico, tenere la batteria, il coperchio e la vite del vano batteria al di fuori della portata dei neonati e dei bambini. Se questi elementi dovessero essere ingeriti, consultare immediatamente un medico.  
NON eseguire l'IAU (Auto-diagnosi e l'auto-trattamento in base ai valori di temperatura ricicatrati). Consultare SEMPRE il proprio medico curante.  
NON utilizzare il termometro per misurare altre se non la temperatura corporea di esseri umani.  
Questo termometro è progettato esclusivamente per la misurazione della temperatura orale e ascellare. NON misurare la temperatura in altri siti, ad esempio nell'orecchio o nel netto, in quanto si rischia di ottenere misurazioni falsate e provocare lesioni.  
NON misurare la temperatura se il termometro è bagnato. Questo potrebbe determinare il risultato della misurazione in modo errato.  
NON usare il dispositivo in contemporanea con altre apparecchiature elettromagnetiche (EM). Questo potrebbe determinare il funzionamento errato dell'apparecchio e/o causare rischi di lesioni.  
NON gettare il termometro nel fuoco.

### Attenzione

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità all'utente o al paziente oppure causare danni all'apparecchio o ad altri danni materiali.

Questo termometro non è resistente all'acqua. NON immergere il termometro in acqua.  
NON utilizzare il termometro in luoghi in cui siano presenti un'intensa elettricità statica o campi elettromagnetici. Questo potrebbe causare risultati di misurazione imprecisi o determinare il funzionamento errato del termometro.  
NON condurre il termometro tra più utilizzatori senza disinferare adeguatamente il dispositivo.  
NON smontare né tentare di riparare il termometro. Questo potrebbe causare risultati imprecisi e/o determinare il funzionamento errato del termometro.  
NON mordere il termometro. Questo potrebbe causare la rottura del dispositivo e/o lesioni personali.  
NON tirare né piegare il termometro.  
NON utilizzare il termometro in luoghi con umidità bassa o elevata o temperature basse o elevate. Fare riferimento alla sezione 9.  
NON lasciare cadere in terra il termometro né la custodia e non sottoporre tali elementi a forti urti o vibrazioni.  
Durante la misurazione, verificare che non siano presenti, entro 30 cm di distanza dal termometro, dispositivi mobili o altri dispositivi elettrici che emettono campi elettromagnetici. Questo potrebbe determinare il funzionamento errato del termometro e/o causare risultati imprecisi.


Utilizzare con il termometro SLO una batteria a bottone al litio tipo CR1220. NON utilizzare altri tipi di batteria.  
Rimuovere la batteria se il termometro dovrà rimanere inutilizzato per 3 mesi o più. Se il liquido della batteria dovesse penetrare negli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita. Consultare immediatamente il proprio medico curante.  
NON sostituire la batteria mentre l'alimentazione è accesa.  
NON utilizzare la batteria dopo la sua data di scadenza.

### 3. Misurazione corretta della temperatura

La precisione della misurazione non può essere garantita se il termometro viene usato in modo errato quando si esegue una misurazione della temperatura.  
**Tempo effettivo per la misurazione della temperatura**  
Misurazione orale: circa 5 minuti  
Misurazione ascellare: circa 10 minuti  
Il segnale acustico NON suona una volta trascorso il tempo sopraindicato. Misurare il tempo automaticamente e ri-muovere il termometro una volta trascorso il tempo indicato.

Prima dell'uso (dai 4 anni in su):  
- Pulire la misurazione la bocca deve rimanere chiusa per un massimo di 5 minuti.  
- Collocare il termometro in bocca, al sotto della lingua, appoggiandolo a sinistra o a destra della base della lingua.  
- Mantenere il termometro fermo facendo pressione con la lingua verso il basso.  
- Mantenere fermo il termometro per evitare che si muova all'interno della bocca.

Il display è rivolto verso l'alto



### 4. Aprire lo schema di trasferimento dell'app sul proprio smartphone.

Aprire il pulsante di alimentazione mentre il simbolo « **o** » lampeggia. Il termometro sarà pronto per trasferire il risultato della misurazione della temperatura.

Non è possibile trasferire il risultato della misurazione della temperatura dopo lo spegnimento del termometro.

Quando il termometro è pronto per il trasferimento, si potrebbe udire del rumore proveniente dal termometro. Non si tratta di un malfunzionamento.

È consigliabile trasferire il risultato della misurazione della temperatura in un ambiente silenzioso.

### 5. Sostituzione della batteria

Batteria a bottone al litio tipo CR1220 (normalmente disponibile in commercio)  
Utilizzare la batteria all'interno del periodo raccomandato indicato dal rispettivo produttore. Sostituire la batteria se all'accensione del termometro appaiono le indicazioni « **C** » e « **A1** ».

1 Rimuovere il coperchio del vano batteria con un piccolo cacciavite a croce.

2 Rimuovere la batteria utilizzando un oggetto sottile, ad esempio una penna.

3 Inserire la nuova batteria con il polo del «+» rivolto verso l'alto, come indicato nella figura che segue.

4 Reinserrire il coperchio del vano batteria e fissarlo con la vite.

La batteria fornita in dotazione può avere una durata inferiore rispetto alle batterie nuove.

### 6. Come alternare °C e °F

1 Con l'alimentazione spenta, premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione per 15 secondi fino a visualizzare « **F** ».

Dopo il cambio di unità, l'alimentazione si spegne automaticamente. Per passare a °C, ripetere il passaggio sopraindicato.

Il simbolo « **o** » e la spia dell'indicatore lampeggiano. La temperatura corporea visualizzata in questo momento rappresenta solo una prima indicazione della temperatura del corpo, perciò potrebbe risultare leggermente diversa rispetto alla temperatura corporea effettiva.

Per conoscere la propria temperatura corporea effettiva, continuare ad applicare il termometro per il tempo specificato di seguito nella sezione "Tempo effettivo per la misurazione della temperatura".

Se si desidera conoscere la propria temperatura al più presto, rimuovere il termometro dal sito di misurazione e leggere il risultato.

NON sostituire la batteria mentre l'alimentazione è accesa.  
NON utilizzare la batteria dopo la sua data di scadenza.

Il display è rivolto verso l'alto



## ES Termómetro digital inteligente Eco Temp Intelli IT (MC-280B)

### Manual de instrucciones



### All for Healthcare

**1. Introducción**  
Gracias por adquirir el termómetro digital OMRON Eco Temp Intelli IT. Este termómetro evita todos los problemas que puede ocasionar la rotura de un cristal, así como el peligro del mercurio. Tenga en cuenta que el tabaco, las bebidas alcohólicas y la comida afectan a la temperatura. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna duda relacionada con las temperaturas corporales específicas.

**Uso previsto**  
El termómetro que ha adquirido ofrece una medida de temperatura segura, exacta y rápida. Puede medir su temperatura en la boca (bucal) o en la axila (axilar).

**Operador previsto**  
Este termómetro está diseñado para ser utilizado por adultos que comprendan este manual de instrucciones. Está diseñado principalmente para su uso en el hogar.

### 2. Información importante sobre la seguridad

Lea atentamente la información importante sobre la seguridad en este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo. Siga rigurosamente este manual de instrucciones para su seguridad. Consérvelo para consultarlo en el futuro.

### Advertencia

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o la muerte.

Mantenga el termómetro fuera del alcance de niños pequeños y bebés. NO deje que los niños utilicen/operen el termómetro sin supervisión. Los niños pueden provocarse lesiones o lesionar a otros niños al intentar tomarse la temperatura sin la supervisión adecuada.  
Mantenga la pila, la tapa de la pila y el tornillo fuera del alcance de los niños pequeños y bebés, ya que las piezas pueden provocar asfixia si son ingeridas.  
NO intente medir la temperatura en otros sitios, como el oído o el recto, ya que puede obtener una lectura errónea y además provocar lesiones.  
NO intente realizar mediciones con el termómetro húmedo. De hacerlo, podría dar lugar a lecturas inexactas.  
NO utilice el dispositivo con otros equipos médicos eléctricos simultáneamente. Podrían provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o dar lugar a una lectura inexacta.

Si se reconociera una diferencia de temperatura entre 2 mediciones consecutivas o fra termómetros diferentes.

Los resultados de la medición de la temperatura se almacenarán de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

El termómetro se apagará automáticamente:  
- 2 minutos después de haber iniciado la transferencia de la medición.  
- 30 minutos después de haber iniciado una medición cuando el resultado de esta no se transfiera.

El resultado de la medición de la temperatura se almacenará de forma automática en la memoria del termómetro. El termómetro solo almacenará la última medición realizada.

## ES Termómetro digital inteligente Eco Temp Intelli IT (MC-280B)